


気化器バルブアッセンブリー交換手順

ブロンコスト・ジャパン株式会社

2016年8月8日

CEM システムのバルブアッセンブリー交換時、取外し時は①～③の順番で取外し、取付時は③～①の順番で取付けて下さい。

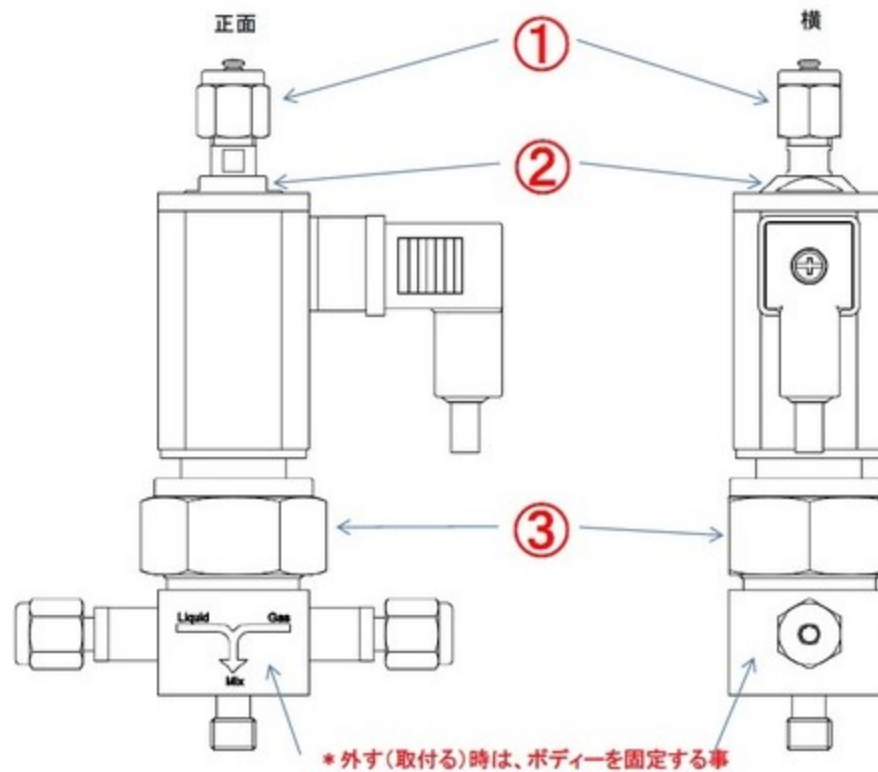

作業時にボディ部分が回転しないように、固定した上で実施して下さい。

※ミキシングバルブはメタルシールを採用しております。交換時にシール面に傷を付けないようご注意ください。リークの原因となり得ます。